

			Datum	08.02.07					= Änderungen vorbehalten	
			Bearb.							
			Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		MS T3 USA ec_ 1/1106	
									page 3 von 7Bl.	

MS T3 USA ec


MS T3 USA ec\_ 1/1106

page 3  
von 7Bl.









tube position  
top view

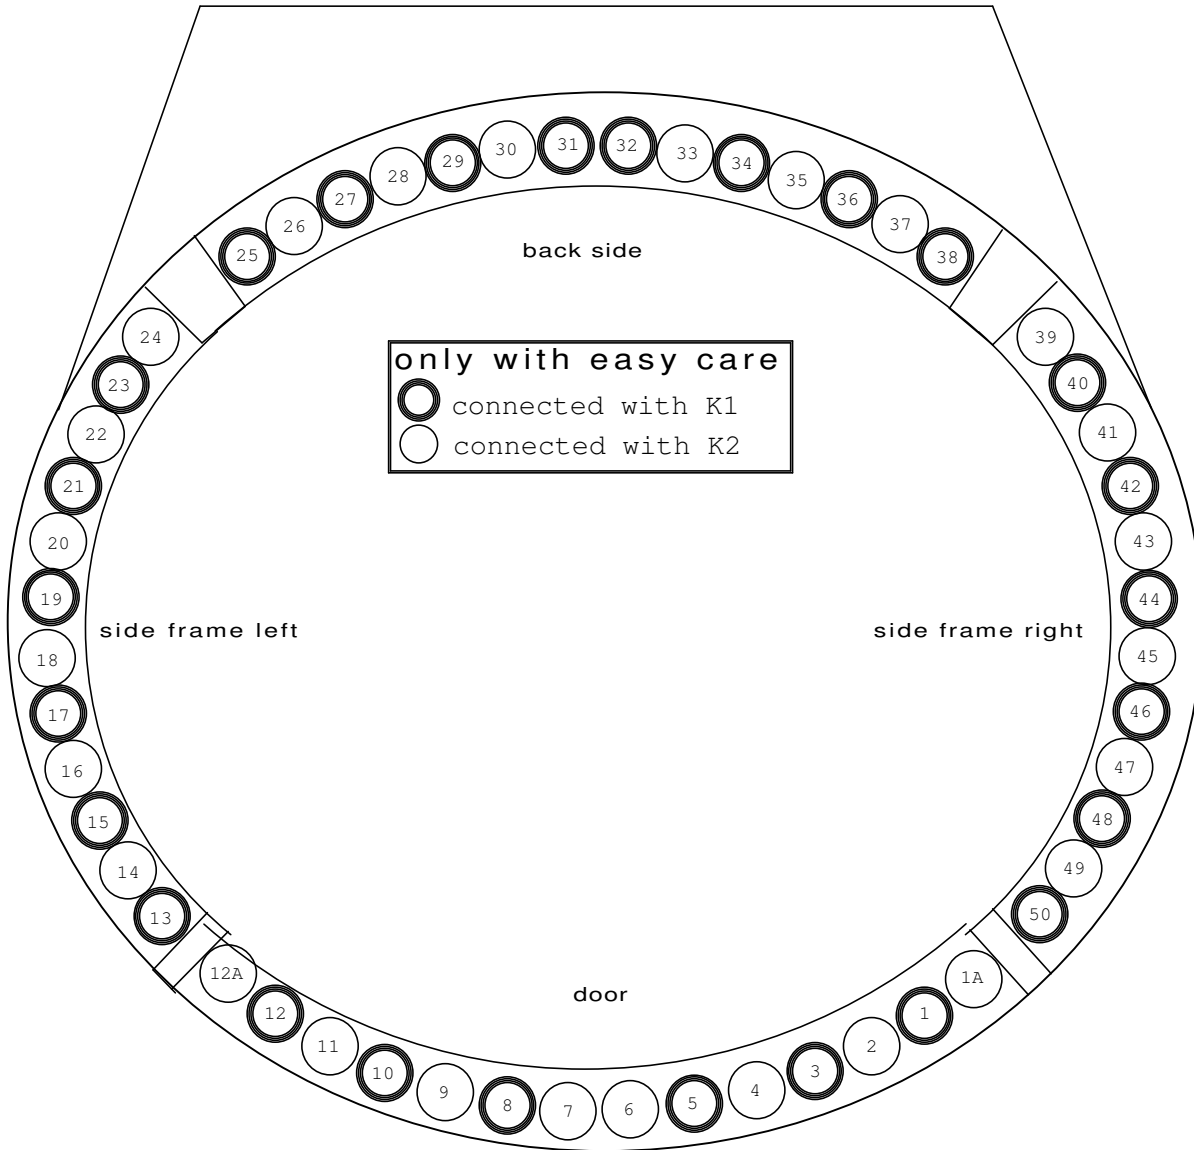

only with easy care  
 ○ connected with K1  
 ○ connected with K2

ballast position

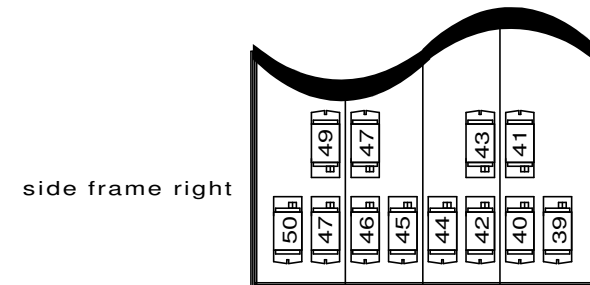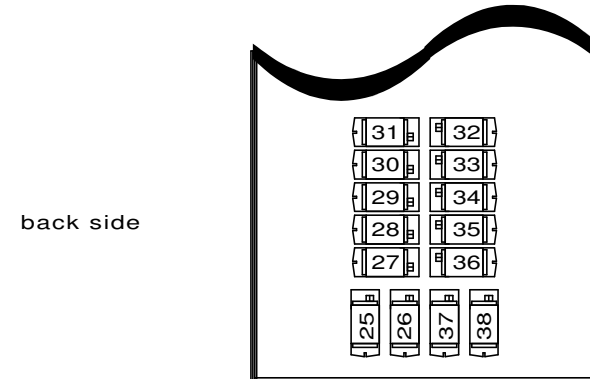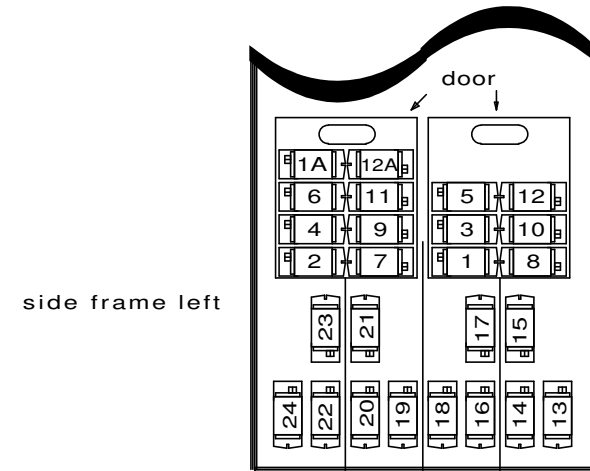

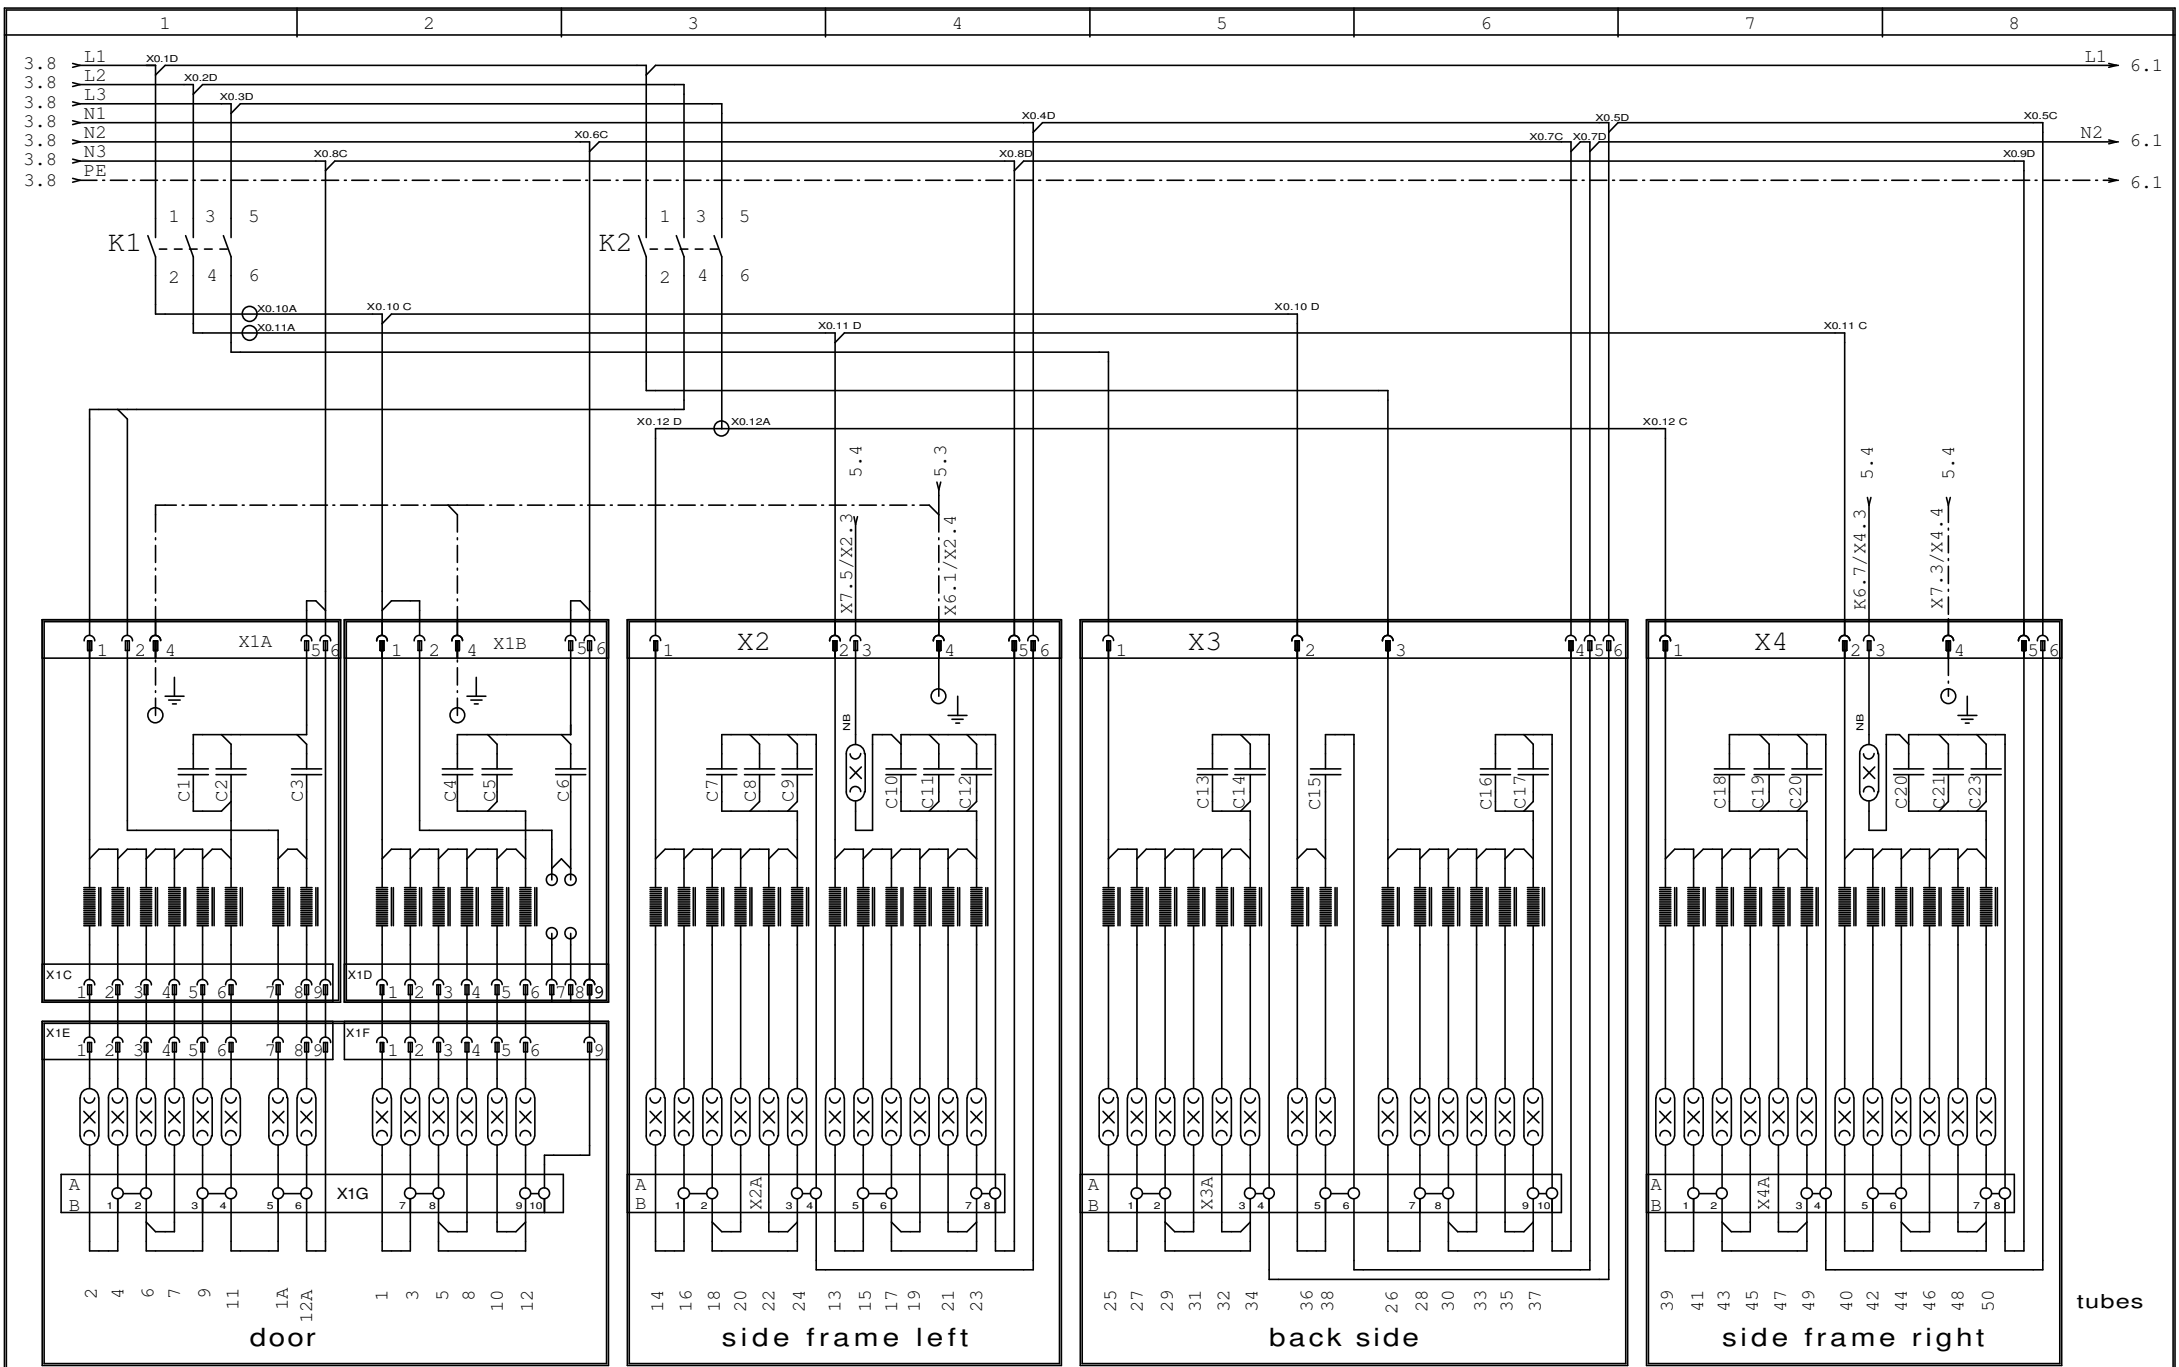

unit T3/50 the ballast and tubes 1A + 12A and the capacitor C3 are not installed

Option easy care connecting diagram (replaced page 4)

		Datum	08.02.07					= Änderungen vorbehalten	
		Bearb.						+	
		Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	MS T3 USA ec	MS T3 USA ec_ 1/1106
									page 7 von 7Bl.



tubes